



منشور

## غش تجاري

1 مارس 2022

يتم ضبط وتحرير العبوات المقلدة والمغشوشة من المستحضر التالي

### **Rhophylac 300 injection** (Human anti - D (Rh) immunoglobulin)

الشركة المصنعة / CSL BEHRING AG-SWITZERLAND  
الشركة صاحبة المستحضر / 2S PHARMA GROUP

ويمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة  
للمستحضر المذكور كما هو موضح بالصورة التالية:

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هَيْئَةُ الدَّوَاءِ المِصْرِيَّة




الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمستحضر

**Rhophylac 300 injection (Human anti – D (Rh) immunoglobulin)**


الشركة المصنعة : CSL BEHRING AG-SWITZERLAND

الشركة صاحبة المستحضر: 2S PHARMA GROUP

**المغشوش**

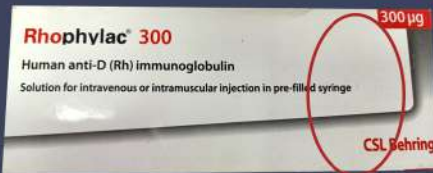

**الأصلي**

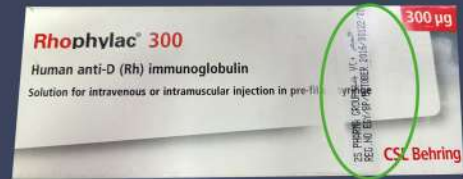

**الغلاف الكرتوني لامعا**

**لا توجد أى مطبوعات**

**(على الوجه الامامي للعبوة)**

**غير مطبوع رقم GTIN /SN على الجزء الجانبي الخاص**

**الغلاف الكرتوني ليس لامعا**

**تتم طباعة السعر مع كلمة "2S PHARMA**

**GROUP" ورقم التسجيل (على الوجه الامامي للعبوة)**

**مطبوع رقم GTIN / SN على الجزء الجانبي الخاص**

**بطباعة رقم التشغيل وتاريخ الانتاج والانتهاء**

**f @egyptiandrugauthority**

**www.edaegypt.gov.eg**

**15301**

**هيئة الدواء المصرية**





# الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمستحضر

## Rhophylac 300 injection (Human anti – D (Rh) immunoglobulin)



الشركة المصنعة : CSL BEHRING AG-SWITZERLAND

الشركة صاحبة المستحضر : 2S PHARMA GROUP

### المغشوش

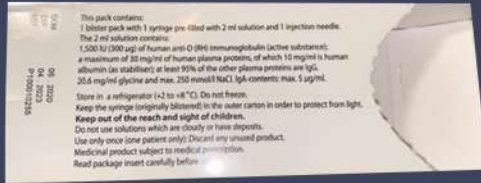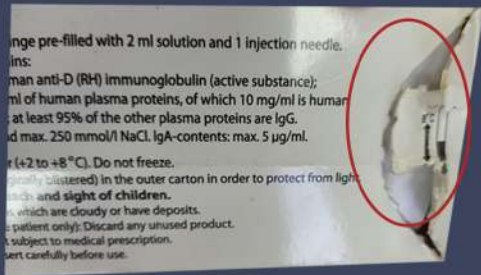

### الأصلي

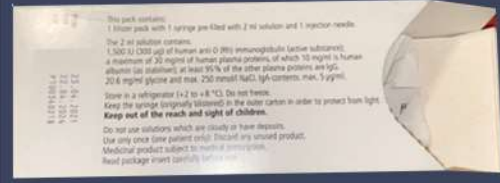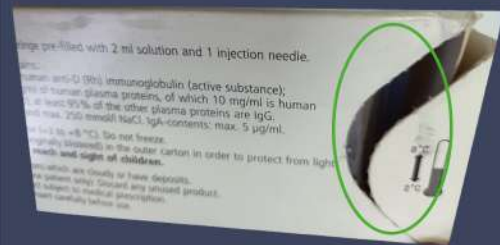

دليل العبث غير احترافي وبعد فتحه تكون العبوة

مقطعة وغير سليمة

على الجانب الخلفي من الكرتون يتم وضع النصوص

في فقرتين فقط

الكتابة بخط غير منتظم

دليل العبث فيه احترافية ويتيح سهولة فتح العبوة

دون تمزيقها

على الجانب الخلفي من الكرتون تنقسم النصوص

إلى 4 فقرات منفصلة

الكتابة بخط رفيع واضح يسهل قراءته

الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمستحضر

**Rhophylac 300 injection (Human anti – D (Rh) immunoglobulin)**

الشركة المصنعة : CSL BEHRING AG-SWITZERLAND

الشركة صاحبة المستحضر: 2S PHARMA GROUP

المغشوش



الغطاء البلاستيكي المستخدم  
لين مع عدم وجود كلمات محفورة أو أحرف  
على أي جانب  
إطار العبوة الداخلي المغلفه كله أبيض

الأصلي



الغطاء البلاستيكي المستخدم للعبوة الداخلية  
سميك مع كلمة "PET" محفورة على جانب واحد وعلى  
الجانب الآخر نقش الحرف "A"  
إطار العبوة الداخلي المغلقة لونه أزرق

الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمستحضر

**Rhophylac 300 injection (Human anti – D (Rh) immunoglobulin)**

الشركة المصنعة : CSL BEHRING AG-SWITZERLAND

الشركة صاحبة المستحضر: 2S PHARMA GROUP

المغشوش



الجانب الخلفي للعبوة الداخليه  
له ملمس بلاستيكي ضعيف ولامع

الأصلي



الجانب الخلفي للعبوة الداخليه  
له ملمس ورقي سميك

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هَيْئَةُ الدَّوَاءِ المِصْرِيَّة



الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمستحضر

**Rhophylac 300 injection (Human anti - D (Rh) immunoglobulin)**

الشركة المصنعة : CSL BEHRING AG-SWITZERLAND

الشركة صاحبة المستحضر: 2S PHARMA GROUP

المغشوش



الأصلي



ليس هناك اي أغطية بلاستيكية للحقنه  
الكتابة بخط غير منتظم يصعب قراءته  
الجهة الامامية للحقنه مشوهة وغير مستقيمة  
الأسهم غير مكتملة ومبهمه

هناك أغطية بلاستيكية في أعلى ومنتصف الحقنة  
الكتابة بخط رفيع واضح يسهل قراءته  
الجهة الامامية للحقنه مستقيمة  
عدد 2 أسهم صغيرة واضحة في الجزء العلوي  
من الحقنه توضح اتجاه فتح الغطاء البلاستيكي العلوي

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هَيْئَةُ الدَوَاءِ المِصْرِيَّة



الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمستحضر

**Rhophylac 300 injection (Human anti – D (Rh) immunoglobulin)**

الشركة المصنعة : CSL BEHRING AG-SWITZERLAND

الشركة صاحبة المستحضر: 2S PHARMA GROUP

المغشوش



الإبرة غير مستقيمة

الجزء البلاستيكي من الإبرة لونه اخضر غامق  
الورقة الخضراء اللاصقة على الإبرة اصفر  
ومع معلومات أقل

الأصلي



الإبرة مستقيمة

الجزء البلاستيكي من الإبرة لونه اخضر فاتح  
الورقة الخضراء اللاصقة على الإبرة كبيرة  
ومع معلومات أكثر تفصيلا بخط واضح